Sécurité, bien-être et simplicité

Découvrez la gamme BabyToLove Flow, des biberons et accessoires garantis sans Bisphénol-A !

Biberon BabyToLove Flow
Il est conçu dans la matière sans BPA (PES) la plus durable et la plus résistante au micro-ondes et aux températures pouvant aller de -30 à 130 degrés.
Il dispose d'une valve anti-colique unique et intégrée au corps du biberon qui régule l'entrée d'air lors de la tétée.
Pratique et très simple, à l'utilisation comme au nettoyage, le corps du biberon ne nécessite aucun assemblage supplémentaire.

Le goupillon BabyToLove :

- Est fabriqué en caoutchouc doux et durable, anti-rayures.
- Permet de nettoyer les moindres recoins du biberon.
- Rend les biberons plus sûrs et utilisables plus longtemps.
- Dispose d'un nettoie-tétine au bout du manche pour tous types de tétines.

Points de vente sur **www.babytolove.com**

Distribué par BabyToLove
86 rue de Buzenval
92210 Saint-Cloud
Tel : 0141129820
Fax : 0141129108
www.babytolove.com

V 02. 26.02.09

Babysense™ II

Babysense - manuel à l'usage des parents

BON DE GARANTIE – BABYSENSE II

Nous garantissons ce produit sans défaut pendant douze mois après sa livraison. En cas de problème pendant cette période, nous vous échangerons le Produit dans un délai raisonnable, compte tenu de la disponibilité des pièces et des informations communiquées par vous. Le dépannage se fera par échange standard après réception du produit accompagné de sa facture et de ce bon de garantie à l'adresse suivante :

BabyToLove
86 rue de Buzenval
92210 Saint-Cloud

Notre garantie ne couvre pas : (i) les dommages causés par l'installation, l'utilisation, les modifications ou réparations faites par un tiers non autorisé ou vous-même, (ii) les dommages dus à une cause externe, (iii) l'adéquation du Produit à tout usage particulier. Ces exclusions ne font pas obstacle à la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code Civil, si le Produit est vendu à un Consommateur.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter sur **www.babytolove.com**

TABLEAU DE DÉPANNAGE - QUESTIONS FRÉQUENTES		
Symptômes	**Cause Possible**	**Solution**
Alarmes	Arrêt cardiaque ou ralentissement brutal de la fréquence cardiaque	**Apporter les premiers secours à l'enfant et appeler les services d'urgences**
	Les 2 détecteurs sont connectés alors que le bébé ne rampe pas encore	Connecter seulement un seul détecteur
	Un seul détecteur est connecté alors que le bébé peut ramper de l'autre coté du lit	Connecter les deux détecteurs
	Le sommier n'est pas rigide	Changer de sommier ou placer dessus une plaque contreplaquée
	Le matelas est trop rigide (polystyrène,..)	Changer de matelas
	Les détecteurs sensoriels sont mal placés	Suivre les instructions du guide d'utilisation
Le délai de mise en route de l'alarme est trop long lors du test fonctionnel	30 secondes semblent être une longue durée à attendre	Contrôler avec une montre SVP
	Le moniteur a détecté une autre influence dans l'environnement tel un courant d'air, un ventilateur, un système d'air conditionné, des vibrations, un jouet mobile...	Identifier et isoler la cause de cette perturbation
	Secousse, mouvement près du lit	Mettre le lit dans un environnement protégé de tout mouvement au sol.
Pas de réponse lorsque l'on allume le moniteur	Piles manquantes ou mal positionnées.	Contrôler que vous avez bien installé les 4 piles nécessaires au fonctionnement de BabySenseII
Alerte de faible autonomie des piles	Les piles doivent être changées	Remplacer les piles

Pour d'autre phénomènes ou mauvais fonctionnements ,n'hésitez pas à nous contacter sur www.babytolove.com

Babysense™ II

manuel à l'usage des parents

Le Syndrome de la Mort Subite du Nourrisson est la première cause de décès des nourrissons au cours de leur première année (de 0 à 12 mois). Ce phénomène est imprévisible, et la médecine n'en a pas encore trouvé les raisons.

Babysense est un appareil de surveillance du mouvement respiratoire à usage domestique, destiné à tous les nourrissons. C'est une sécurité mise à la disposition des parents et des personnes ayant à charge la garde de nourrissons, leur permettant de prévenir les conséquences de l'arrêt respiratoire chez le nouveau-né. Le Syndrome de la Mort Subite du Nourrisson restant inexpliqué et sans solution absolue, Babysense apporte une certaine sécurité au niveau des symptômes qu'il peut détecter – arrêt respiratoire dû à une apnée centrale- arrêt respiratoire consécutif à une déficience cérébrale entraînant une inertie des muscles respiratoires. Babysense est un dispositif de sécurité unique en son genre qui à déjà fait ses preuves en permettant de sauver la vie à plusieurs enfants.

Principales caractéristiques

Babysense contrôle en permanence la fréquence respiratoire et les mouvements de l'enfant.Une alarme visuelle et sonore se déclenche en cas d'arrêt de la respiration au-delà de 20 secondes, ou si la fréquence de la respiration est inférieure à 10 mouvements par minute, lorsque cela se traduit par une absence totale de mouvement de l'enfant. Babysense comporte une unité de contrôle raccordée à 2 détecteurs placés sous le matelas de l'enfant, sans aucun contact avec celui-ci afin de ne pas limiter ou gêner ses mouvements.

Inclus dans ce système

1 Unité de contrôle
2 Détecteurs sous forme de plaques rectangulaires
1 Cable de connexion
1 Support crémaillère permettant d'accrocher l'unité de contrôle.

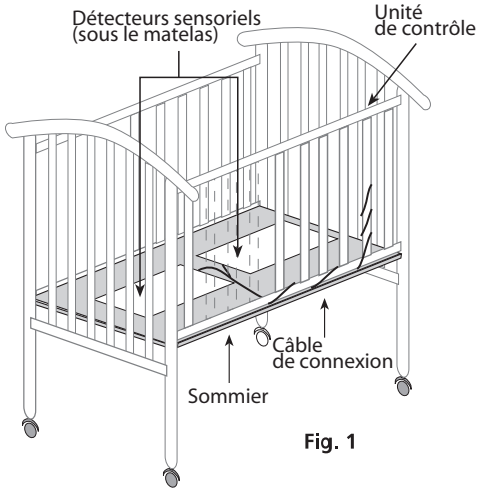

Fig. 1

Installation

1 Placer les deux détecteurs sur le sommier de lit (figure1) ou un détecteur sur la base de la couchette de l enfant. Placez le matelas sur les détecteurs, et vérifiez qu'il soit bien disposé. Si le matelas ne peut etre disposé de façon à faire contact avec les détecteurs, ou si le sommier est à ressorts, une planche en bois doit être placée sur le sommier, les détecteurs seront placés sur celle-ci, et le matelas posé par-dessus.

2 Ouvrez le compartiment à piles (figure3), enlevez la câle de la protection, et introduisez 4 piles identiques de types LR6-AA de 1,5 volts neuves, de préférence de type alcaline, en suivant les indications de mise en place.
Ne jamais réutiliser des piles usagées avec des piles neuves.
Remettez la câle de protection, et fermez le compartiment à piles.

3 Raccordez les câbles des détecteurs au double connecteur du câble, et branchez l'autre coté du cable-connecteur à l'unité de contrôle.

4 Insérez la crémaillère au dos de l'unité de contrôle dans l'emplacement prévu à cet effet (figure3). Suspendez l'unité de contrôle sur le coté extérieur du lit ou dans tout autre endroit convenable, hors de la portée de l'enfant. Serrez la crémaillère selon convenance, afin que l'unité de contrôle soit fixée solidement.(La connexion du ou des détecteur(s) à l'unité de contrôle ne répond pas à une procédure spécifique).

Installation pour un nouveau-né

Pour une sensibilité accrue, dans le cas d'un nouveau-né non encore mobile, il est conseillé de n'utiliser qu'un seul détecteur. Lorsque l'enfant sera devenu plus mobile, les deux détecteurs devront être utilisés.

Si vous n'utilisez qu'un seul détecteur sensoriel, vous devez connecter directement le câble à l'unité de contrôle sans utiliser le réceptacle jumelé des connecteurs.

Important : Pour éviter tout danger, il est recommandé de tendre les câbles pour qu'ils ne pendent pas autour du lit (soit en les enroulant aux barreaux et cadres du lit, soit en resserrant les câbles sous le lit à l'aide d'un fil de serrage – Voir figure 1)

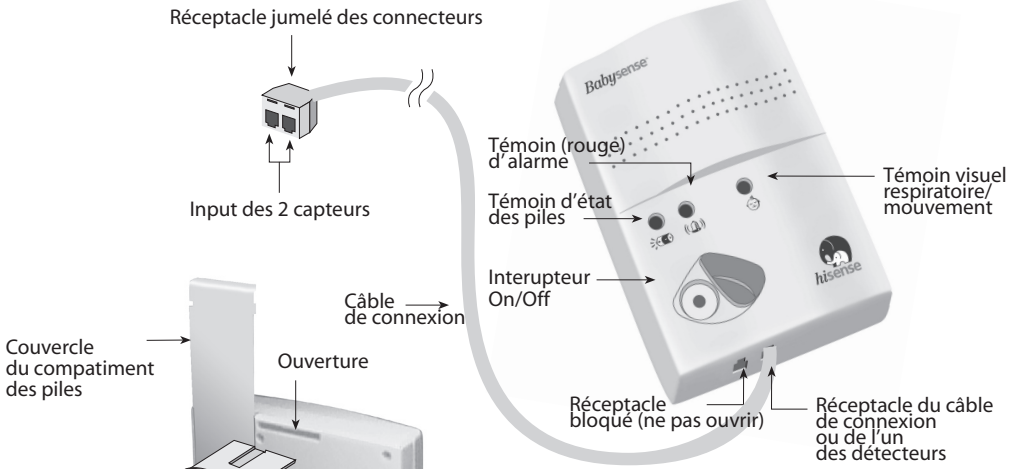

Fig. 2

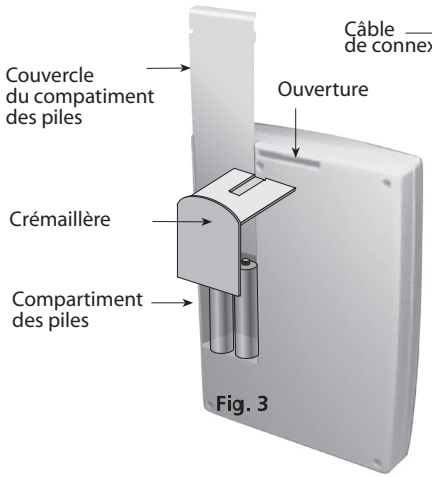

Fig. 3

Fonctionnement
Description de l'unité de contrôle (figure2)

L'unité de contrôle comprend les indicateurs ayant les fonctions suivantes :
- Un interrupteur marche/arrêt protégé par un volet coulissant. (évitant toute interruption involontaire de fonctionnement de l'appareil).
- Un voyant lumineux vert clignotant à chaque respiration ou mouvement.
- Un voyant lumineux rouge en conjonction avec l'alarme, s'éclairant si le rythme du mouvement respiratoire est en dessous de la normale.
- Un voyant lumineux rouge clignotant dès la baisse de puissance des piles.

Pour faire fonctionner Babysense appuyez sur l'interrupteur.Les voyants rouges s'éclairent un court instant et s'éteignent automatiquement suivis d'un déclic sonore signalant la fin de la procédure interne de test électronique de l'appareil, et son bon fonctionnement. L'appareil affiche à présent un clignotement du voyant vert à chaque mouvement du nourrisson, respiratoire ou autre. Pour arrêter Babysense, appuyez de nouveau sur le bouton interrupteur. Si le voyant rouge d'état des piles reste allumé ou clignote, ceci indique une faible puissance des piles. Celles-ci devront être remplacées à court terme. Si le clignotement de ce voyant est accompagné d'un déclic sonore, les piles doivent êtres remplacés immédiatement.
La durée de fonctionnement des piles (piles alcalines)), sera d'environ 4 mois, dans des conditions normales d'utilisation.

TEST FONCTIONNEL DE Babysense

Babysense est un instrument à haute sensibilité qui détecte à travers le matelas, les mouvements respiratoires, ou tout autre mouvement, de l'enfant endormi. Le mauvais fonctionnement de l'appareil peut survenir :
- En cas de défaillance technique
- En cas d'influence de facteurs extérieurs d'environnement

Défaillance technique :
La mauvaise connexion, ou la déconnexion des détecteurs peuvent déclencher l'alarme sonore. En cas de défaillance de l'unité de contrôle, l'appareil ne peut pas fonctionner.
Afin de minimiser le risque de défaillance technique, il est important de bien suivre les instructions d'installation décrites dans ce guide.

Influence de facteurs extérieurs d'environnement :
Étant donné sa haute sensibilité, le fonctionnement de Babysense pourrait être influencé par des facteurs extérieurs tels que :courants d'air, ventilateurs, climatisation, vibrations mécaniques, ….Les différents effets de ces facteurs extérieurs pourraient être perçus par les détecteurs comme les mouvements respiratoires de l'enfant, et pourrait ainsi empêcher ou retarder le déclenchement de l'alarme.

C'est pourquoi des tests fonctionnels de Babysense doivent être réalisés de la manière suivante :
Vérifier que le voyant vert clignote quand le bébé est dans son lit. Sortez l'enfant du lit sans éteindre Babysense. Le voyant vert continue de clignoter pendant une à deux minutes avant que l'alarme ne se déclenche. Ce délai est dû au relâchement de la pression à la surface du matelas après avoir soulevé le bébé, ce qui ne surviendrait pas dans le cas où l'enfant s'arrêterait de respirer dans son lit.

- Après que l'alarme se soit déclenchée, éteignez Babysense en appuyant sur l'interrupteur, puis remettez-le en marche par une nouvelle pression, sans bouger le lit. Vérifiez que l'alarme se déclenche en moins de 30 secondes, et que celle-ci peut être entendue de l'endroit où vous vous trouvez. Il est conseillé de procéder à ce test fonctionnel quotidiennement en sortant l'enfant de son lit.

Repérage, isolation et traitement de facteurs extérieurs d'environnement.

-Si l'alarme ne s'est pas déclenchée au bout de 30 secondes, des facteurs de pertubations extérieures devront être détectés et isolés.

Ainsi, changez la position d'un
ventilateur, fermez une fenêtre ou une porte, changez la position du lit, etc.

En cas de déclenchement de l'alarme, intervenez immédiatement :
1 Approchez vous du lit de l'enfant. Vérifiez que l'enfant a réellement cessé de respirer. Si cela est le cas, soulevez l'enfant et tapez lui doucement sur le dos ou sur l'épaule. Vérifiez qu'il n'existe pas d'indices d'étouffement.

2 Si la respiration ne reprend pas, des soins d'urgence doivent être administrés (voir document ci-joint), et un traitement médical appliqué.

3 Il peut se produire de rares cas de fausses alarmes. Vérifier que celles-ci ne sont pas dûes à de mauvais branchements des détecteurs sur l'unité de contrôle.De même ,si les détecteurs ne sont pas en contact direct avec la face inférieure du matelas, ou si le matelas est constitué d'un matériau trop dur comme du polystyrène expansé ou du liège, des cas de fausses alertes peuvent se produire.

-------IMPORTANT--------
L'utilisation de cet appareil n'exclut pas la vigilance des parents

Babysense surveille et alarme mais n'empêche pas l'arrêt de la respiration. Il est de votre ressort d'administrer le cas échéant, des soins d'urgence.
Babysense détecte le mouvement de la respiration ou tout autre type de mouvements mais ne détecte pas d'autres phénomènes. Cet appareil avertit en cas de d'arrêt du mouvement de la respiration du bébé ou d'autres mouvements, ou d'une baisse de leur fréquence. Ce phénomène pourrait être dû au Syndrome de la Mort Subite –résultat d'une apnéee centrale qui est une défaillance du système nerveux central – à une déficience cérébrale entraînant une inertie des muscles respiratoires, ou pourrait provenir d'autres causes.

VOTRE INTERVENTION D'URGENCE EST NECESSAIRE EN CAS D'ALERTE.

Entretien
Babysense ne nécessite aucun entretien particulier,à part le remplacement des piles dès que nécessaire.
Certaines précautions doivent être prises :
-Ne pas immerger l'unité de contrôle. De même, ne pas répandre de liquide dessus.

-Ne pas laisser les piles dans l'unité de contrôle si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période (plusieurs mois).Les piles usagées doivent être déposées auprés de points de récupération prévus à cet effet, et non pas jetées à la poubelle .

-Utilisez de nouvelles piles lorsqu'une nouvelle mise en service de l'appareil est envisagée.

Nettoyage
L'unité de contrôle peut être nettoyée avec un linge alcoolisé, les détecteurs avec un linge humide savonné. En aucun cas n'utilisez de dissolvant ou tout autre produit corrosif.

Durée de vie du dispositif
Utilisé dans les conditions décrites au sein des présentes instructions, la durée de vie de l'unité de contrôle est estimée à 4 ans, celle des détecteurs à 2 ans. L'année de fabrication de chaque dispositif est inscrite sur l'étiquette apposée au dos de l'unité de contrôle.

Conditions de garantie
Babysense est garantie port une période de 12 mois, à partir de la date d'achat de l'appareil (suite à l'envoi du récépissé complété de mise en place de la période de garantie, joint au certificat).

En cas de défaillance du dispositif, ou de problème de fonctionnement veuillez nous contacter par téléphone, afin de nous permettre de vérifier si le problème rencontré peut être résolu verbalement. Si nécessaire nous procéderons au remplacement de l'unité de contrôle, et vous expliquerons comment nous renvoyer l'appareil défectueux (dans ce cas, veuillez indiquer par écrit la nature du problème rencontré).